

[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Aktenzeichen
Bearbeiter/in
Durchwahl
Fax
E-Mail
Internet:
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht
Datum: 06.03.2012
Seite: 1 von 4

Messung des Biogasertragspotenzials

Prüfbericht zu Tgb.-Nr. 12/ BG/ 01029 und 30

Bezeichnung der Probe: 12/BG/01029 Oliventrester
12/BG/01030 Olivenwaschwasser
eingegangen am: 03.01.2012
Untersuchungsauftrag: [REDACTED]
Einsender:
Datum der Probenahme:
Untersuchungszeitraum: Jan-Feb..2012

Die Bestimmung des Biogasertragspotenzials erfolgte im Eudiometer nach DIN 38414 S 8 - in der Anlage des [REDACTED]. Das Material wurde in der angelieferten Form mit Fermentergülle als Substrat 30 Tage mesophil (39°C +/- 1°C) im Batch Verfahren behandelt. Die Gasmessungen wurden täglich durchgeführt.


Die Angaben erfolgen unter Normalbedingungen (273K, 1013 hPa, abzügl. H₂O Dampf)

Hauptsitz:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Standort:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]



Probe: 12/ BG/ 01029 und 30

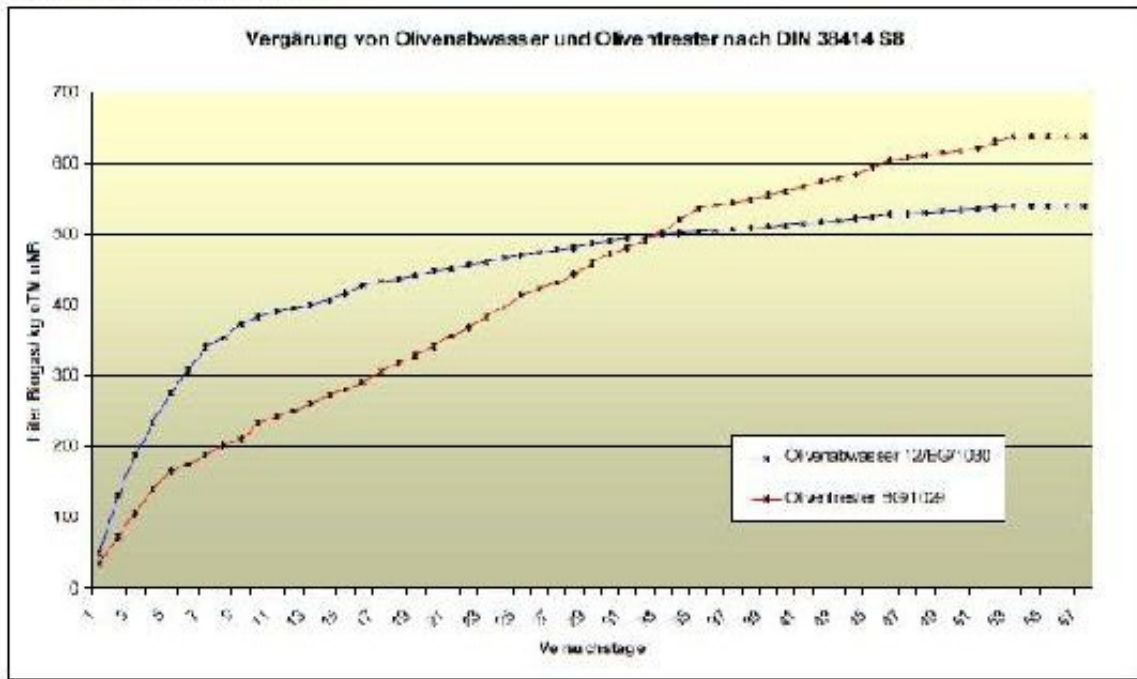

Probe	Biogasertrag Liter Gas/kg oTS u. NB n. 35 Tagen	Trockensubstanz [%]	Organische Trockensubstanz z [%]	Glührückstand [%]
12/BG/C1029 Oliventrester	534,60	83,58	74,48	9,08
12/BG/C1030 Olivenwaschwasser	503,73	27,22	25,48	1,74

Messwerte:

Messtage	Biogas	
	Olivenabwasser 12/BG/1030	Oliventrester BG/1029
Angaben in Liter Gas/kg oTM u. NB		
1	50,34	35,48
2	131,21	73,59
3	187,27	107,03
4	234,48	140,63
5	275,35	164,43
6	308,62	176,30
7	339,27	188,18
8	354,81	202,58
9	373,33	210,44
10	382,62	232,86

Hauptsitz:
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 E-Mail: [Redacted]

Standort:
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 E-Mail: [Redacted]



Geplante Arbeitszeit: Anrufe und Besuche bitte Montag bis Donnerstag zwischen 7:30 – 18:30 Uhr,
 Freitag von 7:30 – 15:00 Uhr oder nach Vereinbarung

11	391,00	241,22
12	396,13	251,20
13	401,25	261,11
14	407,09	271,05
15	417,83	281,90
16	427,97	292,48
17	432,83	306,13
18	437,69	316,11
19	442,30	326,02
20	446,98	341,52
21	451,40	356,98
22	455,83	369,63
23	460,60	383,76
24	465,38	397,89
25	469,99	413,79
26	473,88	422,96
27	477,76	432,12
28	481,92	444,47
29	486,07	458,66
30	490,22	472,85
31	493,23	481,82
32	496,14	490,72
33	499,05	504,72
34	501,97	520,04
35	503,73	534,60
36	505,50	539,79
37	507,27	544,97
38	509,04	550,15
39	510,80	555,34
40	513,10	561,17
41	515,39	567,01
42	517,69	572,84
43	519,98	578,68
44	522,28	584,51
45	524,92	593,96
46	527,57	603,28
47	528,81	606,83
48	530,31	610,44
49	531,81	614,05
50	533,31	617,66
51	534,81	621,27
52	537,10	629,42
53	539,31	637,50
54	539,31	637,50
55	539,31	637,50
56	539,31	637,50
57	539,31	637,50

Hauptsitz:
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 E-Mail: [Redacted]

Standort:
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 E-Mail: [Redacted]

Gleisende Arbeitszeit: Anrufe und Besuche bitte Montag bis Donnerstag zwischen 7:30 – 16:30 Uhr.
 Freitag von 7:30 – 15:00 Uhr oder nach Vereinbarung

